

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 266820/VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Sản xuất đồ lót Lovely-VN

Địa chỉ: Số 40B, Phạm Hữu Lầu, Ấp 4, Xã Phước Kiên, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: KTYT-SEN 2

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất đồ lót Lovely-VN

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà


Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG

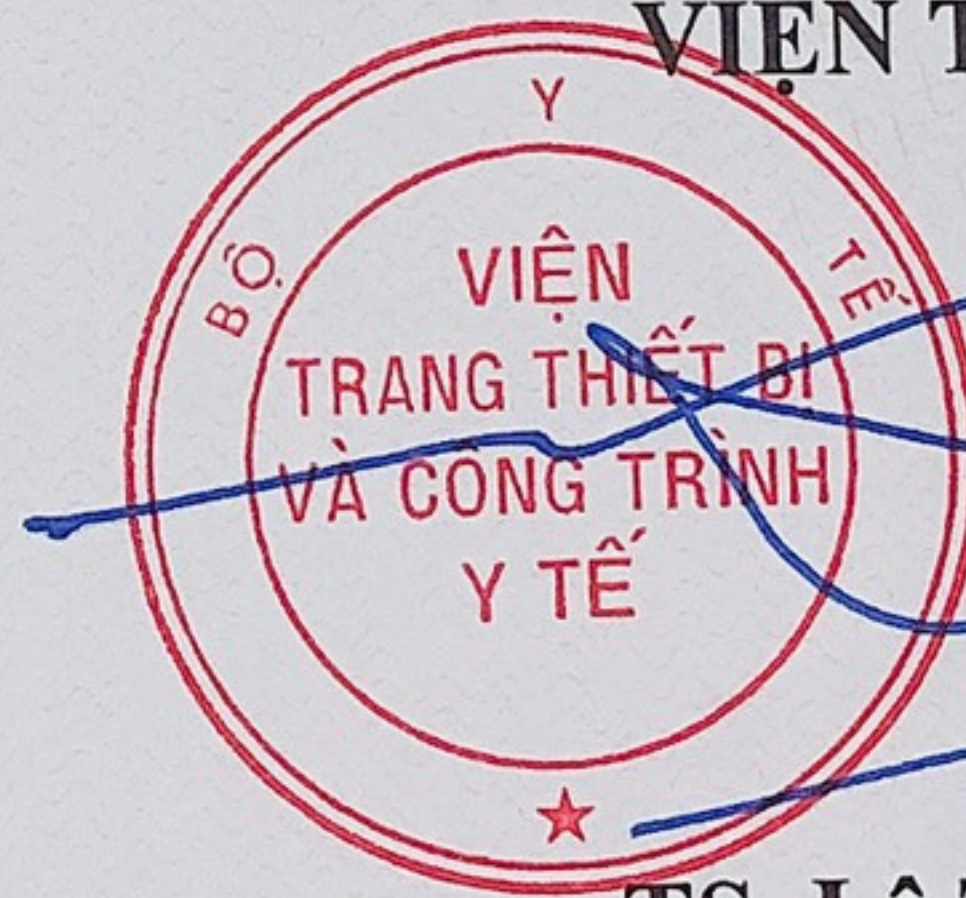

TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật


TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Sản xuất đồ lót Lovely-VN cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 04/06/2020.*


Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

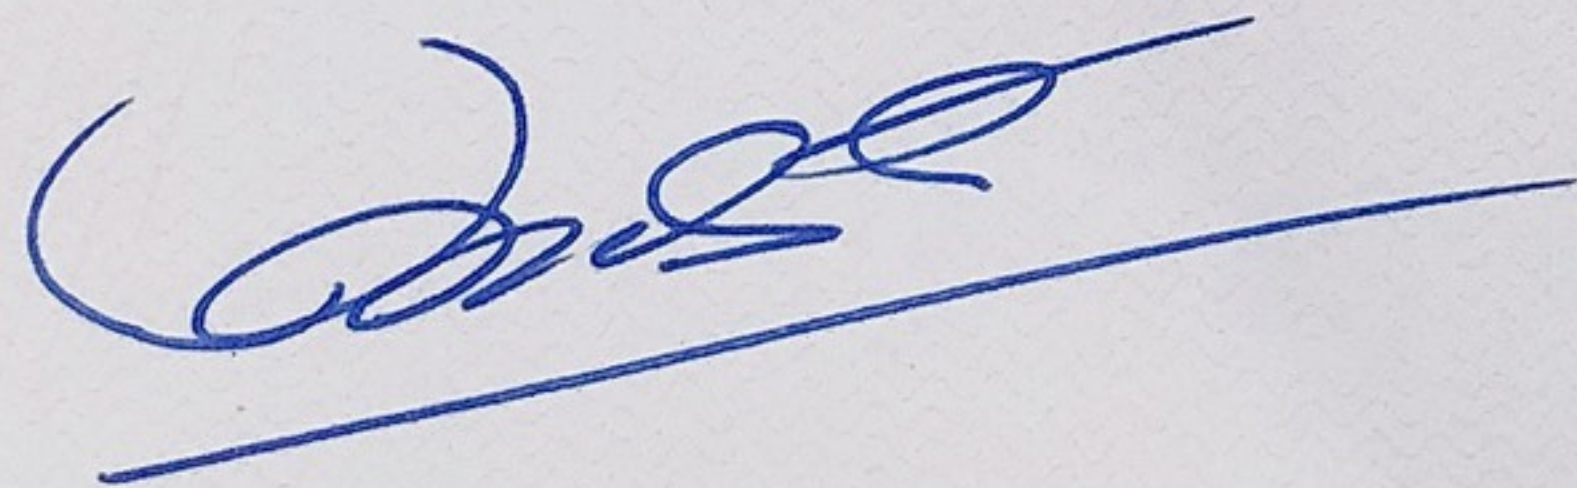

Nguyễn Văn Hùng

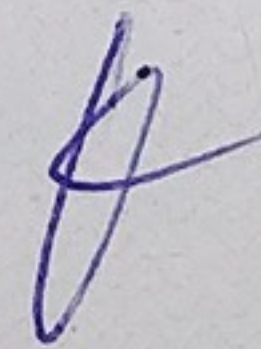

Lê Đức Hà