

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *27620* /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Một thành viên Cuộc sống an toàn Việt Nam

Địa chỉ: 33/6 Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Safemask

Model: 4 lớp

Đơn vị sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Kiến Văn

Địa chỉ: 1358/21/18 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Phạm Thanh Tùng


Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG

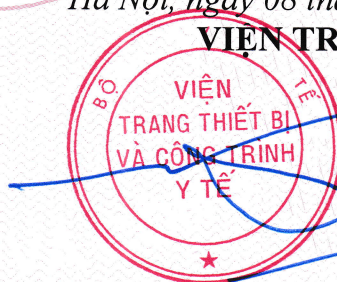

TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Một thành viên Cuộc sống an toàn Việt Nam cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 05/06/2020.

SOÁT XÉT

Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Phạm Thanh Tùng