


cobas[®] Plasma Separation Card

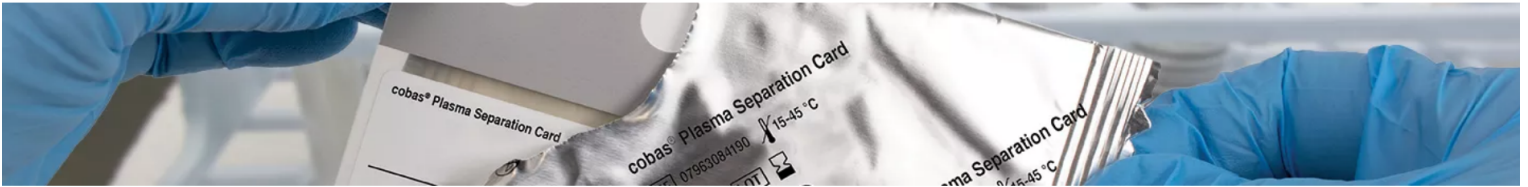


Định nghĩa lại khả năng tiếp cận các xét nghiệm đáng tin cậy

Bản phân tách huyết tương **cobas[®] Plasma Separation Card** là một dụng cụ thu mẫu ổn định và dễ dàng sử dụng cho xét nghiệm đo tải lượng vi-rút HIV trong huyết tương. Bằng cách cung cấp một lượng nhỏ máu của bệnh nhân từ đầu ngón tay, bản phân tách được thiết kế đặc biệt này giúp đơn giản hóa việc lấy máu và vận chuyển mẫu. Bản phân tách cho phép xét nghiệm định lượng đáng tin cậy đối với bệnh nhân nhiễm HIV sống ở vùng sâu vùng xa - ngay cả những vùng có nhiệt độ và độ ẩm rất cao - đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn về độ nhạy của WHO là < 1000 cp/mL cho xác định tải lượng vi-rút HIV trước khi bắt đầu điều trị.


[LIÊN HỆ](#)

Các thông tin liên quan

Chương trình tiếp cận toàn cầu Global Access Program [↗](#)

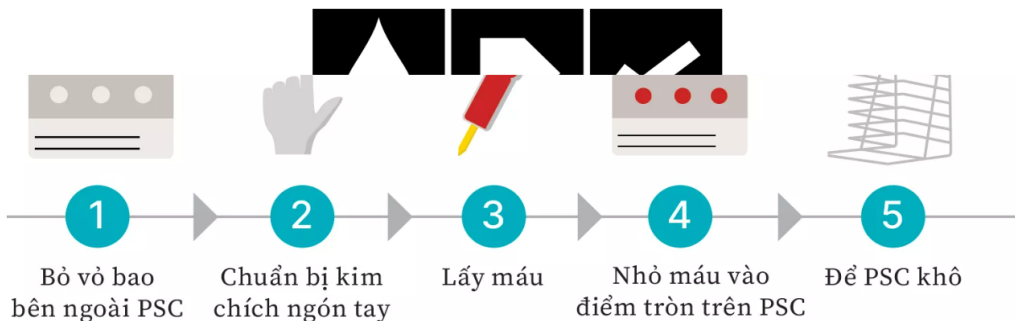

Vận chuyển mẫu từ nơi lấy mẫu đến phòng xét nghiệm

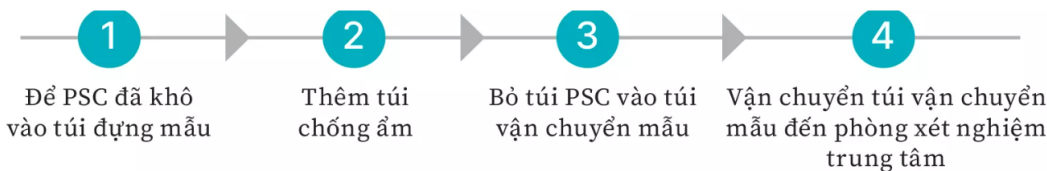

Đưa xét nghiệm lên tầm cao mới với **cobas[®] Plasma Separation Card**



Nơi tiếp cận đến nguồn lực và nguồn cung cấp không đáng tin cậy.

Nơi mà việc vận chuyển có thể là một nhiệm vụ lâu dài và gian khổ.

Nơi mà HIV/AIDS tấn công cộng đồng nhiều nhất.

Giải pháp thu mẫu sáng tạo giúp xét nghiệm tin cậy tiếp cận được người cần nhất.

Định nghĩa lại khả năng tiếp cận xét nghiệm đo tải lượng vi-rút HIV tin cậy



Tiêu chuẩn của WHO < 1000 cp/mL

(ở mẫu huyết tương)
cobas® Plasma Separation Card là giải pháp thu mẫu có chứng nhận CE đáp ứng được tiêu chuẩn này của WHO.



Giải pháp tải lượng HIV

Để thu mẫu đo tải lượng vi-rút HIV ở những khu vực hạn chế nguồn lực.



Dễ dàng thao tác, vận chuyển và bảo quản

Cung cấp giải pháp dễ dàng sử dụng để theo dõi bệnh nhân ở các khu vực xa xôi.



Mẫu dựa vào huyết tương

(tiêu chuẩn vàng) Tách từ máu toàn phần. Ổn định huyết tương khô / RNA của vi-rút dưới nhiệt độ và độ ẩm rất cao.



Sự tương đương với huyết tương như là tiêu chuẩn VÀNG

Các giải pháp hiện nay có sự tương đương hạn chế và thấp hơn - tiên quyết cho việc phân loại.



Tương thích

Phù hợp với hệ thống COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® và hệ thống **cobas**® 4800/5800/6800/8800.

COBAS, AMPLIPREP và TAQMAN là nhãn hiệu thương mại của Roche.

Thông tin đăng ký sản phẩm

cobas® Plasma Separation Card

IVD lấy mẫu và ổn định mẫu huyết tương khô
cobas® Plasma Separation Card
Mã sản phẩm: 09411763190

Hãng sản xuất, nước sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Đức
Chủ sở hữu, nước chủ sở hữu: Roche Molecular Systems Inc., Mỹ
Số lưu hành: 230000245/PCBA-HCM

Chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số văn bản công bố:
Số tài liệu: MC-VN-00635



[CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG](#)

[THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ](#)

[CHÍNH SÁCH COOKIE](#)

[LIÊN HỆ](#)

[TỰY CHỌN COOKIES](#)

[TUYÊN BỐ AN NINH MẠNG](#)

[VIỆT NAM / TIẾNG VIỆT](#)

Trang này gồm các thông tin về sản phẩm hướng tới đồng đảo bạn đọc và có thể có những thông tin sản phẩm không có hiệu lực tại quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi truy cập thông tin nào vi phạm quy định, quy trình pháp lý, đăng ký và sử dụng tại quốc gia của bạn.

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Số ĐKKD: 0310805269

Ngày cấp: 09/04/2011, được sửa đổi lần thứ 8, ngày 14/01/2020

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Email: roche_vietnam.info@roche.com

©2022 F. Hoffmann-La Roche Ltd

Cập nhật gần nhất: 15.05.2023