

Độ tin cậy cao trong nhiều ứng dụng

Xi măng nhựa tự dán 3M™ RelyX™ U200




Công nghệ xi măng nhựa tự dán đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng trên khắp thế giới

Với sự đơn giản, tiện lợi và đáng tin cậy, xi măng nhựa tự dán 3M™ RelyX™ U200 là sản phẩm hàng đầu cho nhiều mục đích sử dụng đa dạng. Nhờ khả năng tự dán và cơ chế lưỡng trùng hợp, xi măng 3M™ RelyX™ U200 mang lại độ bền dán cao, bền màu, ổn định lâu dài cùng nhiều tính năng nổi bật khác.

Phù hợp với: Gắn phục hình thông thường, phục hình sứ oxít, chốt và cầu răng.

Kết quả của The Dental Advisor Nghiên cứu hiệu quả lâm sàng trong 15 năm +++++
Kết quả theo dõi các phục hình trong 15 năm khi được gắn với 3M™ RelyX™ Unicem/Unicem 2™

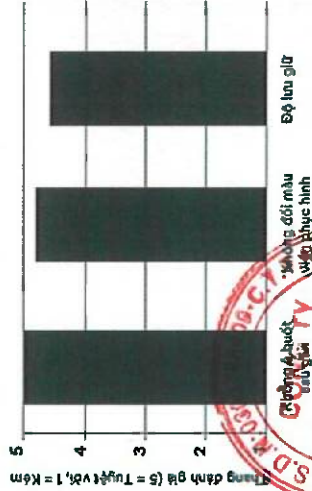

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M VIỆT NAM
Nghiên cứu The Dental Advisor 15 năm
Clinical Performance Study, 03/2017
Hiệu quả lâm sàng đạt Tuyệt Vời +++++
Kết quả theo dõi các phục hình trong 15 năm khi được gắn với 3M™ RelyX™ Unicem 2™

Lê Thanh Bình Giám Đốc

Đáp ứng mọi nhu cầu của phòng khám và bệnh nhân!

- Tiết kiệm thời gian nhờ bỏ qua các bước etching, bonding và priming
- Hầu như không gây ê buốt sau khi gắn
- Bền dán
- Chịu ẩm
- Endo tips giúp việc gắn chốt dễ dàng và đáng tin cậy hơn

Chỉ định (++ Khuyến nghị cao/+ Khuyến nghị)


Chỉ định	Kim loại/ Sườn kim loại	Sử dụng tính (theo các tiêu chuẩn của ANSI/ADA Type 4 or Type 5)	Sứ oxít (theo tiêu chuẩn của ANSI/ADA Type 1) (Power)	Nhựa composite (theo tiêu chuẩn của ANSI/ADA Type 4)
Inlay/Onlay	++	+	++	+
Mão/Cầu răng	++	++	++	++*
Chốt nội nha	++		++	++
Cầu dán Maryland	+		+	
Trên trụ Implants	++	+	++	++

*Chỉ nên dùng

Sự đơn giản mang lại hiệu suất cao

Kết hợp hiệu suất của xi măng nhựa với sự tiện lợi của xi măng thông thường giúp loại bỏ các bước etching, bonding, priming

Hướng dẫn từng bước với zirconia, hoặc mão và cầu kim loại.

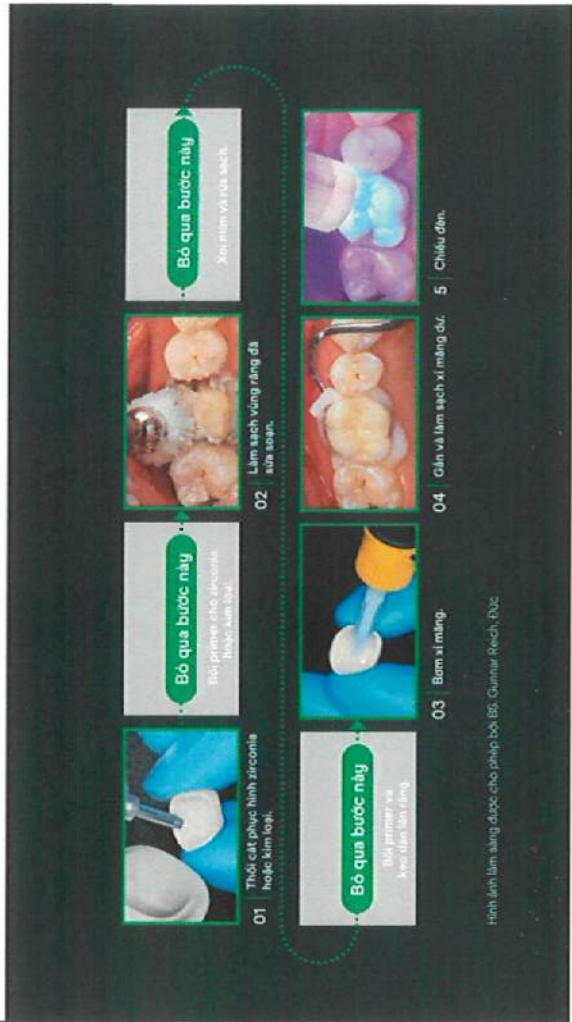

Hình ảnh làm sáng được cho phép bỏ B5, Gunnar Reich, Đức

Công nghệ xi măng nhựa tự dán
được nhiều chứng minh lâm sàng
trên thế giới.

Hơn 30 nghiên cứu lâm sàng từ 27 trường đại học đã cho thấy hiệu suất của xi măng RelyX Unicem. Gần 3.000 phép hình đã được thực hiện trên 1.600 bệnh nhân từ 14 quốc gia và được phân sát trong tới đa số 15 năm.¹⁻³² Các nghiên cứu bao gồm nhiều thí định khác nhau phục hình sứ thủy tinh,¹⁻⁴ mào và cầu zirconia^{5-10,33} và kim loại^{11-14, 16, 19, 21, 23, 34} phục hình composite gắn tiếp, chốt nhựa gia cố sợi^{15, 16, 20, 31} và chốt kim loại trong nhô.^{20, 24, 25} Các nghiên cứu cũng bao gồm các tình trạng đặc biệt như nghiền răng khi ngủ,²⁶ cấu răng vôi và phục hình trên¹⁴ implant.



Bảng chứng lâm sàng xác nhận hiệu suất đăng tin của xi măng RelyX Unicem 2/U200, đặc biệt là đối với mão và cốt răng zirconia, kim loại và lithium disilicate cùng một chất *loại* và *chất* số. Những phát hiện của trường đại học này được công bố trên tạp chí *Journal of Prosthetic Dentistry* vào tháng 1 năm 2015. Những phát hiện của trường đại học này được công bố trên tạp chí *Journal of Prosthetic Dentistry* vào tháng 1 năm 2015.

- 01 Piliavin et al., *J. Appl. Behav. Anal.*, 2023, **56**, 375 (10777-06)
- 02 Sommer et al., *Clin. Neuro. Sci.*, 2019, **34**, 273
- 03 Leinhardt et al., *Clin. Neuro. Sci.*, 2019, **34**, 273
- 04 Perrais et al., *Eur. J. Prosthet. Dent.*, 2023, **117**, 799-800
- 05 Leinhardt et al., *Clin. Oral Invest.*, 2023, **117**, 799-800
- 06 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 07 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 08 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 09 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 10 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 11 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 12 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 13 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 14 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 15 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 16 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 17 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 18 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 19 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 20 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 21 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 22 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 23 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 24 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 25 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 26 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 27 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 28 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 29 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 30 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 31 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 32 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 33 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 34 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017
- 35 Leinhardt et al., *J. Dent. Res.*, 2022, **101**, Spec. Iss. A3017

Thông tin sản phẩm

ReliX™ U200 Clicker™				
Mã	Sản phẩm	Số Lot/Hành	Chủ Sở Hữu Số Lot/Hành	Hãng Sản Xuất/Nước Sản Xuất
56877	Màu Translucent	220000922/ PCBB-BYT	Công ty TNHH 3M Việt Nam	3M Deutschland GmbH Đức
56878	Màu A2 Universal			
56879	Màu A3 Opaque			
ReliX™ U200 Automix				
Mã	Sản phẩm	Số Lot/Hành	Chủ Sở Hữu Số Lot/Hành	Hãng Sản Xuất/Nước Sản Xuất
56897	Màu Translucent	240002047/ PCBB-HCM	Công ty TNHH 3M Việt Nam	3M Deutschland GmbH Đức
56895	Màu A2 Universal			
56896	Màu A3 Opaque			
ReliX™ U200 Automix - Đầu trộn thay thế				
Mã	Sản phẩm			
56913	(30) Đầu trộn (thường)			
56914	(15) Đầu trộn (cột) & endo tips			
56917	(15) Đầu trộn (cột) & intra-oral tips			



Relyx™ U200 Automatic
(1) Ống dạng Automatic 8.5g
(2) Đầu tròn (thường), (5) Đầu tròn (dài) & endo tips

ReliX™ U200 Clicker™
(1) Ống dạng Clicker™ Yg. (1) Giấy tròn

MILIA NGAY



Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
Công ty TNHH 3M Việt Nam, Tầng 20, Mapletree Business
Centre, 1050 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.