


thoraflex™ hybrid

Khung giá đỡ động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ

RELAY® PRO

Khung giá đỡ nội mạch chủ ngực

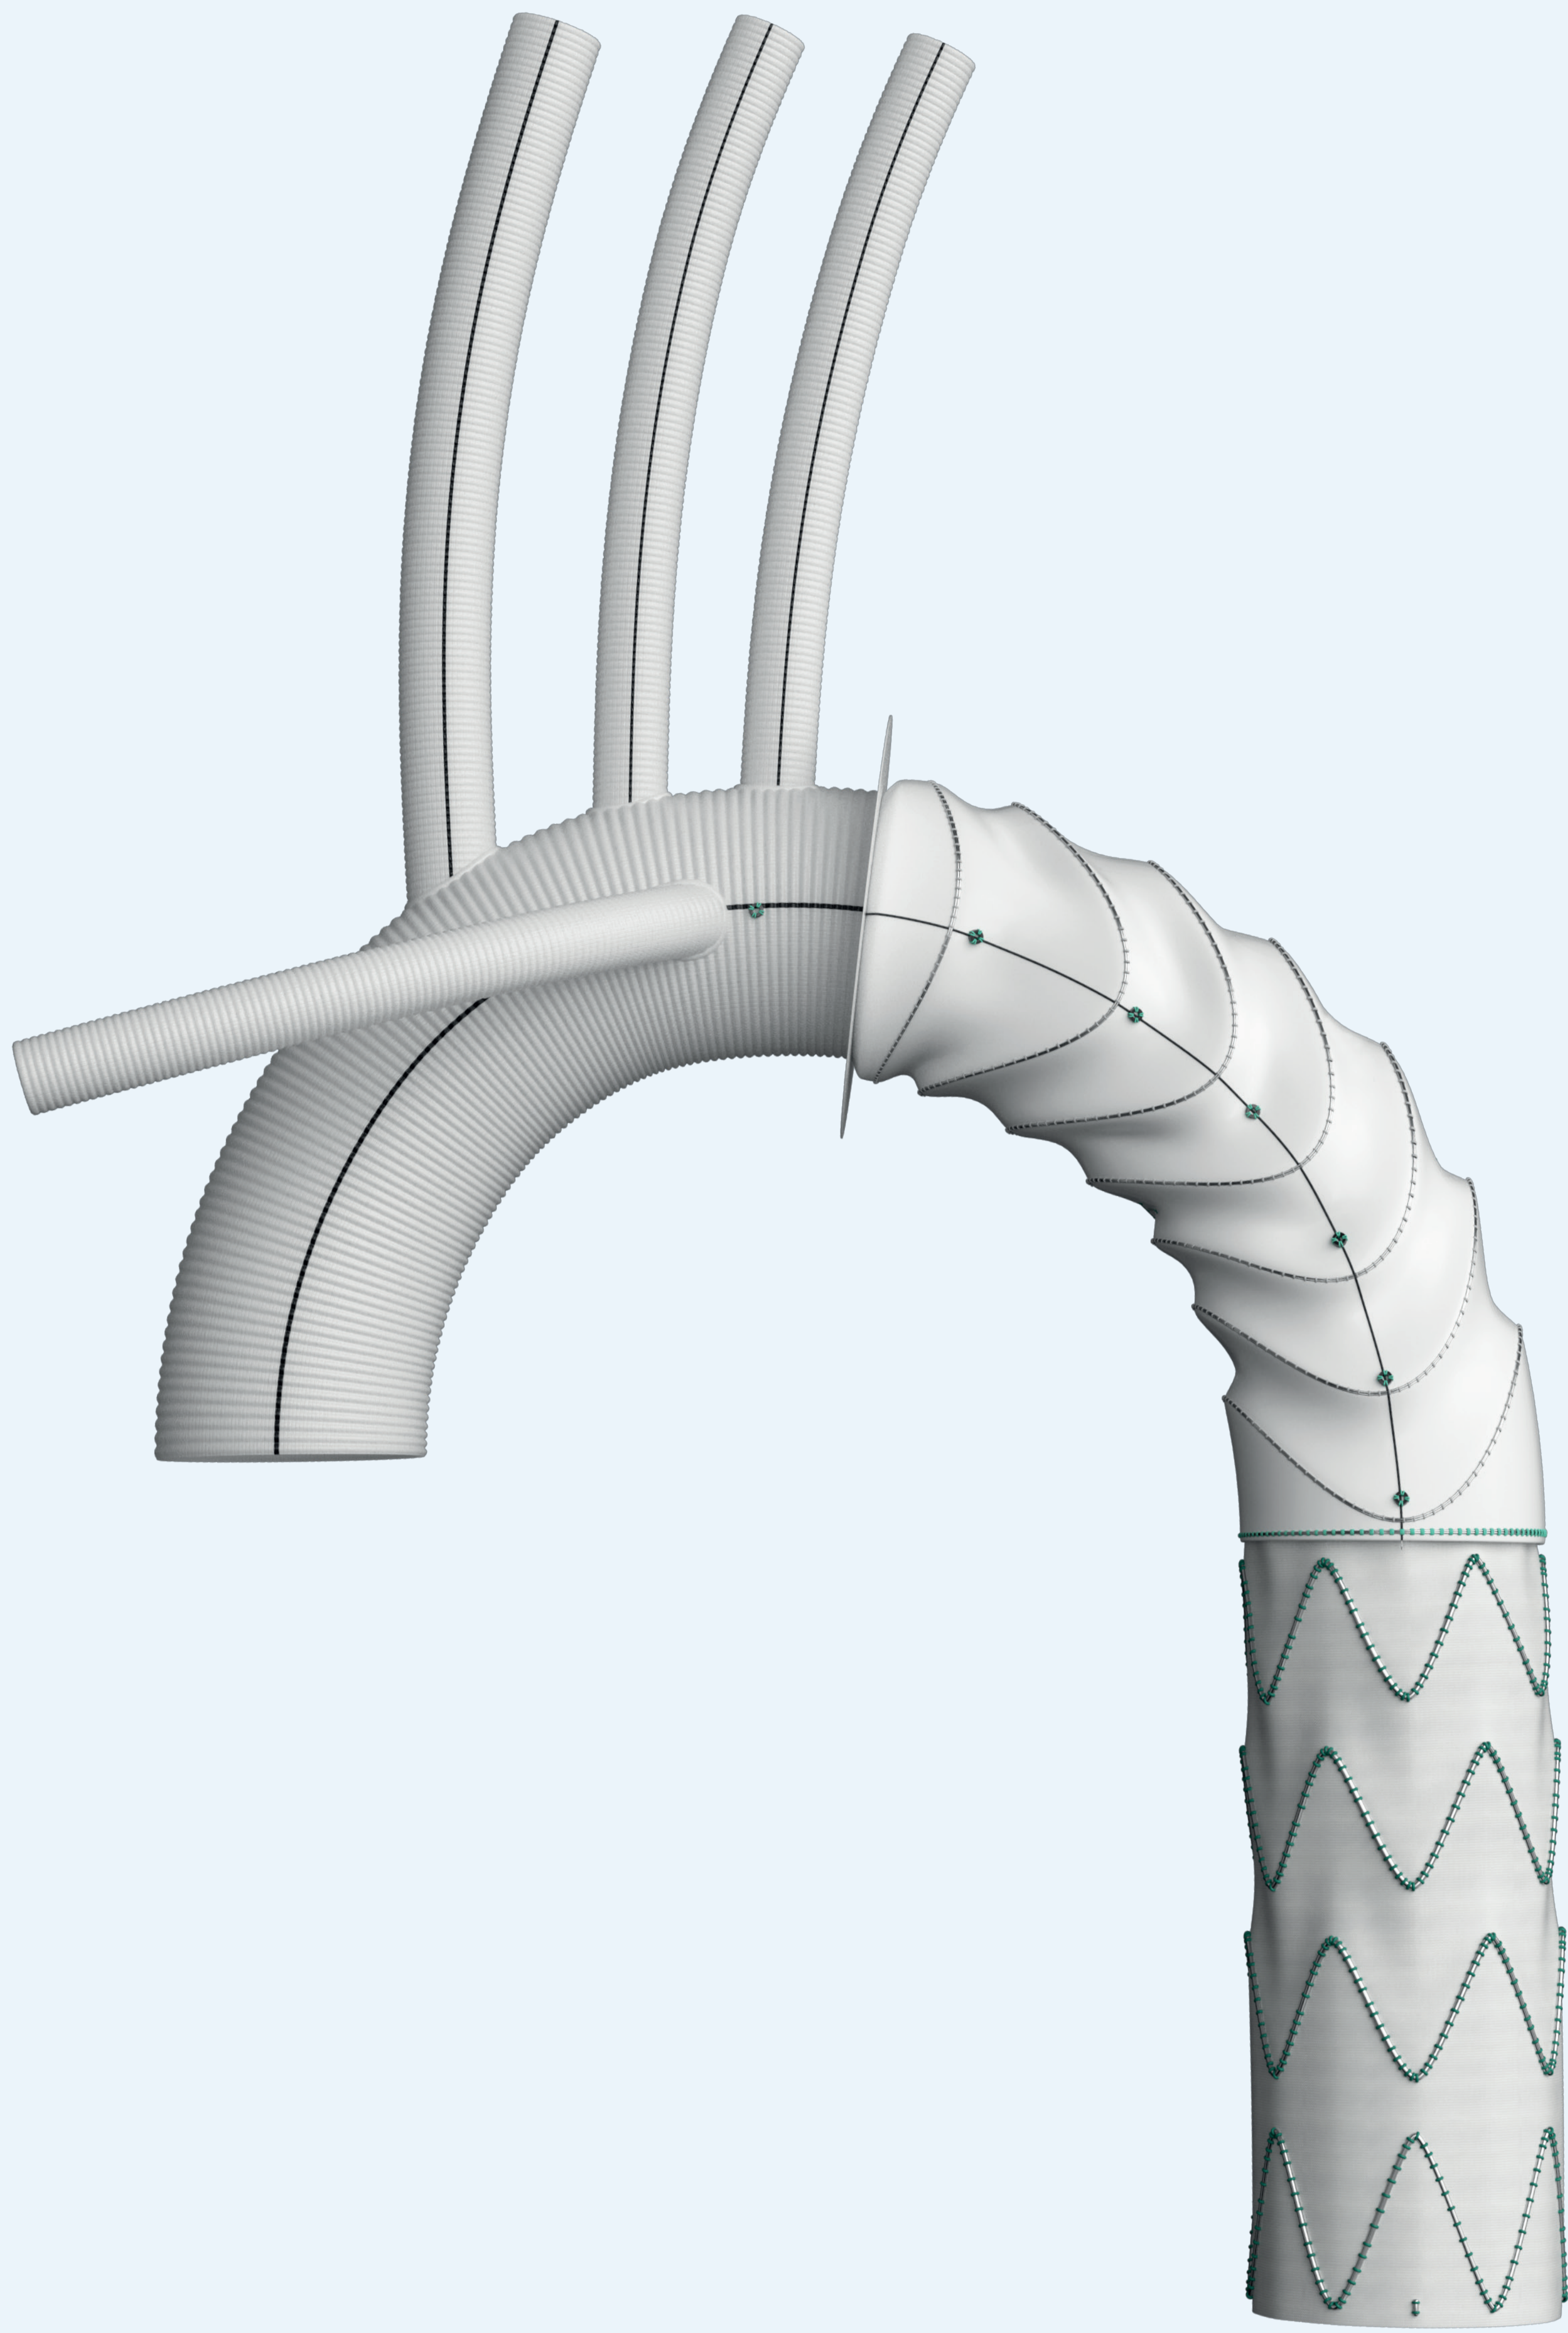

Kế hoạch cho Tương lai với Can thiệp Thứ cấp theo Khuyến cáo

Gần **33%** ca FET cần can thiệp thứ cấp ở động mạch chủ xuống¹
FDA chấp thuận **Relay® Pro** cho can thiệp kéo dài kết hợp với **Thoraflex™ Hybrid**

1. Kreibich, M et al, 2020. Aortic reinterventions after the frozen elephant trunk procedure. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 159(2), pp.392-399.

Sản phẩm có sẵn tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý địa phương

Chú ý: Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này được bán bởi hoặc theo chỉ định của bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề.

Tên BHYT:

1. Khung giá đỡ động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ
2. Khung giá đỡ nội mạch chủ ngực

Số lưu hành:

1. 2402838ĐKLH/BYT-HTTB
2. 2301853ĐKLH/BYT-HTTB

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng, nước sản xuất:

1. Vasutek Limited - Vương quốc Anh
2. Bolton Medical, Inc. - Mỹ

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 103,104/25-CKQC-Terumo