

Nhãn phụ của thiết bị y tế khi lưu hành tại Việt Nam:

Tên thiết bị y tế: Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroid Peroxidase

Chủng loại: Antibodies to Thyroid Peroxidase Quantitative Detection KIT (Chemiluminescent Immunoassay)

Mã sản phẩm: KH-G-L-335-02-CE

Quy cách đóng gói: 100 Test/Hộp

Số ĐKLH:

Số seri/Số lô: Tham khảo nhãn gốc của nhà sản xuất

Ngày sản xuất: Tham khảo tài liệu/nhãn gốc của nhà sản xuất

Thông số kỹ thuật: Tham khảo tài liệu của nhà sản xuất

Cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Tham khảo tài liệu của nhà sản xuất và xem trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc

Chủ sở hữu TBYT: Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.

Địa chỉ: 1189 North Qinzhou Road, 200233 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Chủ sản xuất TBYT: Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.

Địa chỉ: 1189 North Qinzhou Road, 200233 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Đơn vị nhập khẩu/ Chủ sở hữu Lưu hành/ Đơn vị bảo hành:


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIANLONG VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 608, tầng 6 tòa nhà Trung tâm thương mại, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng


NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 020220845", "CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIANLONG VIỆT NAM", and "THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG".


**GIÁM ĐỐC
LIANG JIANGMING**

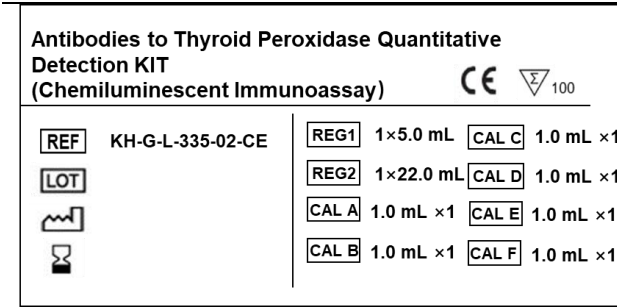


Label on front of outer package




Label on side of outer package

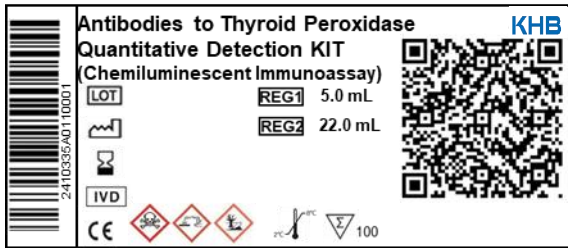


Label on reagent bottle holder




Label on CAL A




Label on CAL B




Label on CAL C



Label on CAL D



Label on CAL E



Label on CAL F




R1 bottle spraying



R2 bottle spraying

上海自立
2025.6.4

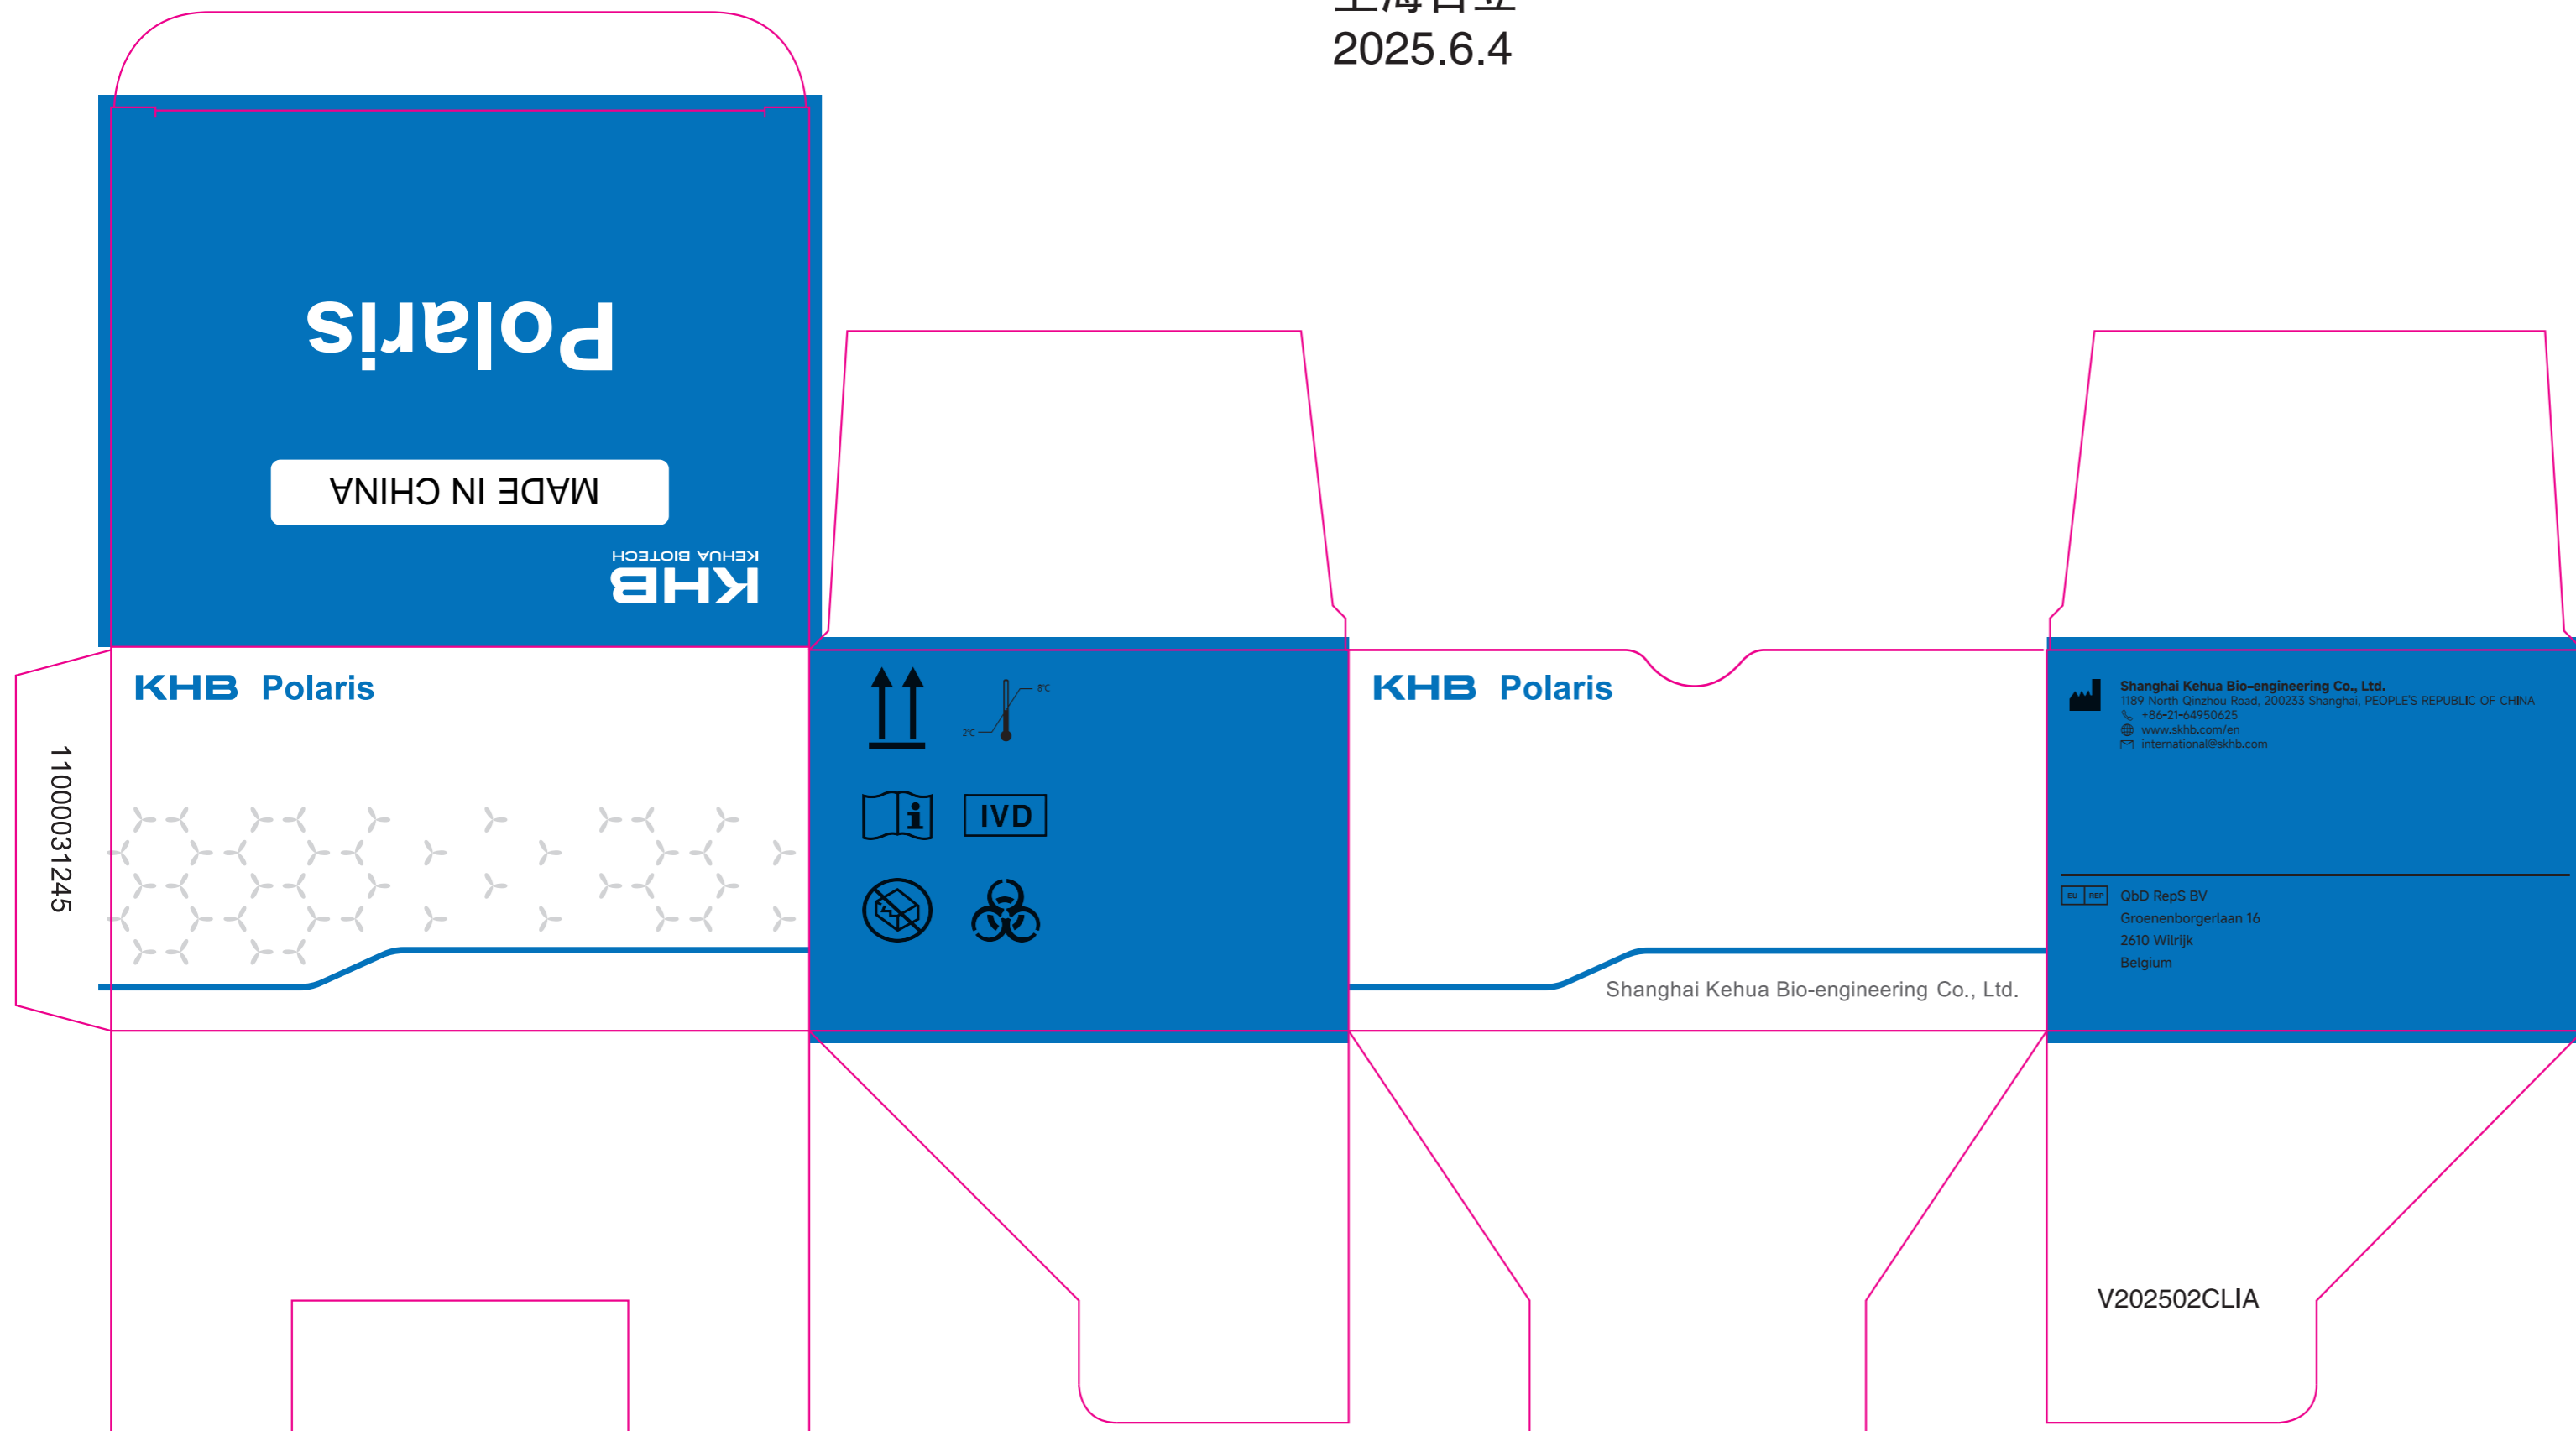

印刷品名称	北极星发光试剂外盒 (CE)	
版本号(若有)	V202502CLIA	
物料代码	11000031245	
材 质	400克白卡	
潘通色号	 PT:285C	 K100
尺 寸	110x85x60mm	
工 艺	哑膜	
修订说明		
备 注		
/	部 门	签名/日期
编制人	设计与成果转化中心	
审核人	法规事务部	
	质量控制部	
	质量保证部	
	国际业务部	
批准人	质量保证部	
	智造中心	